



# ABUTMENT COMPATIBILI


Sistema Interface IPD



# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Schema di lavoro

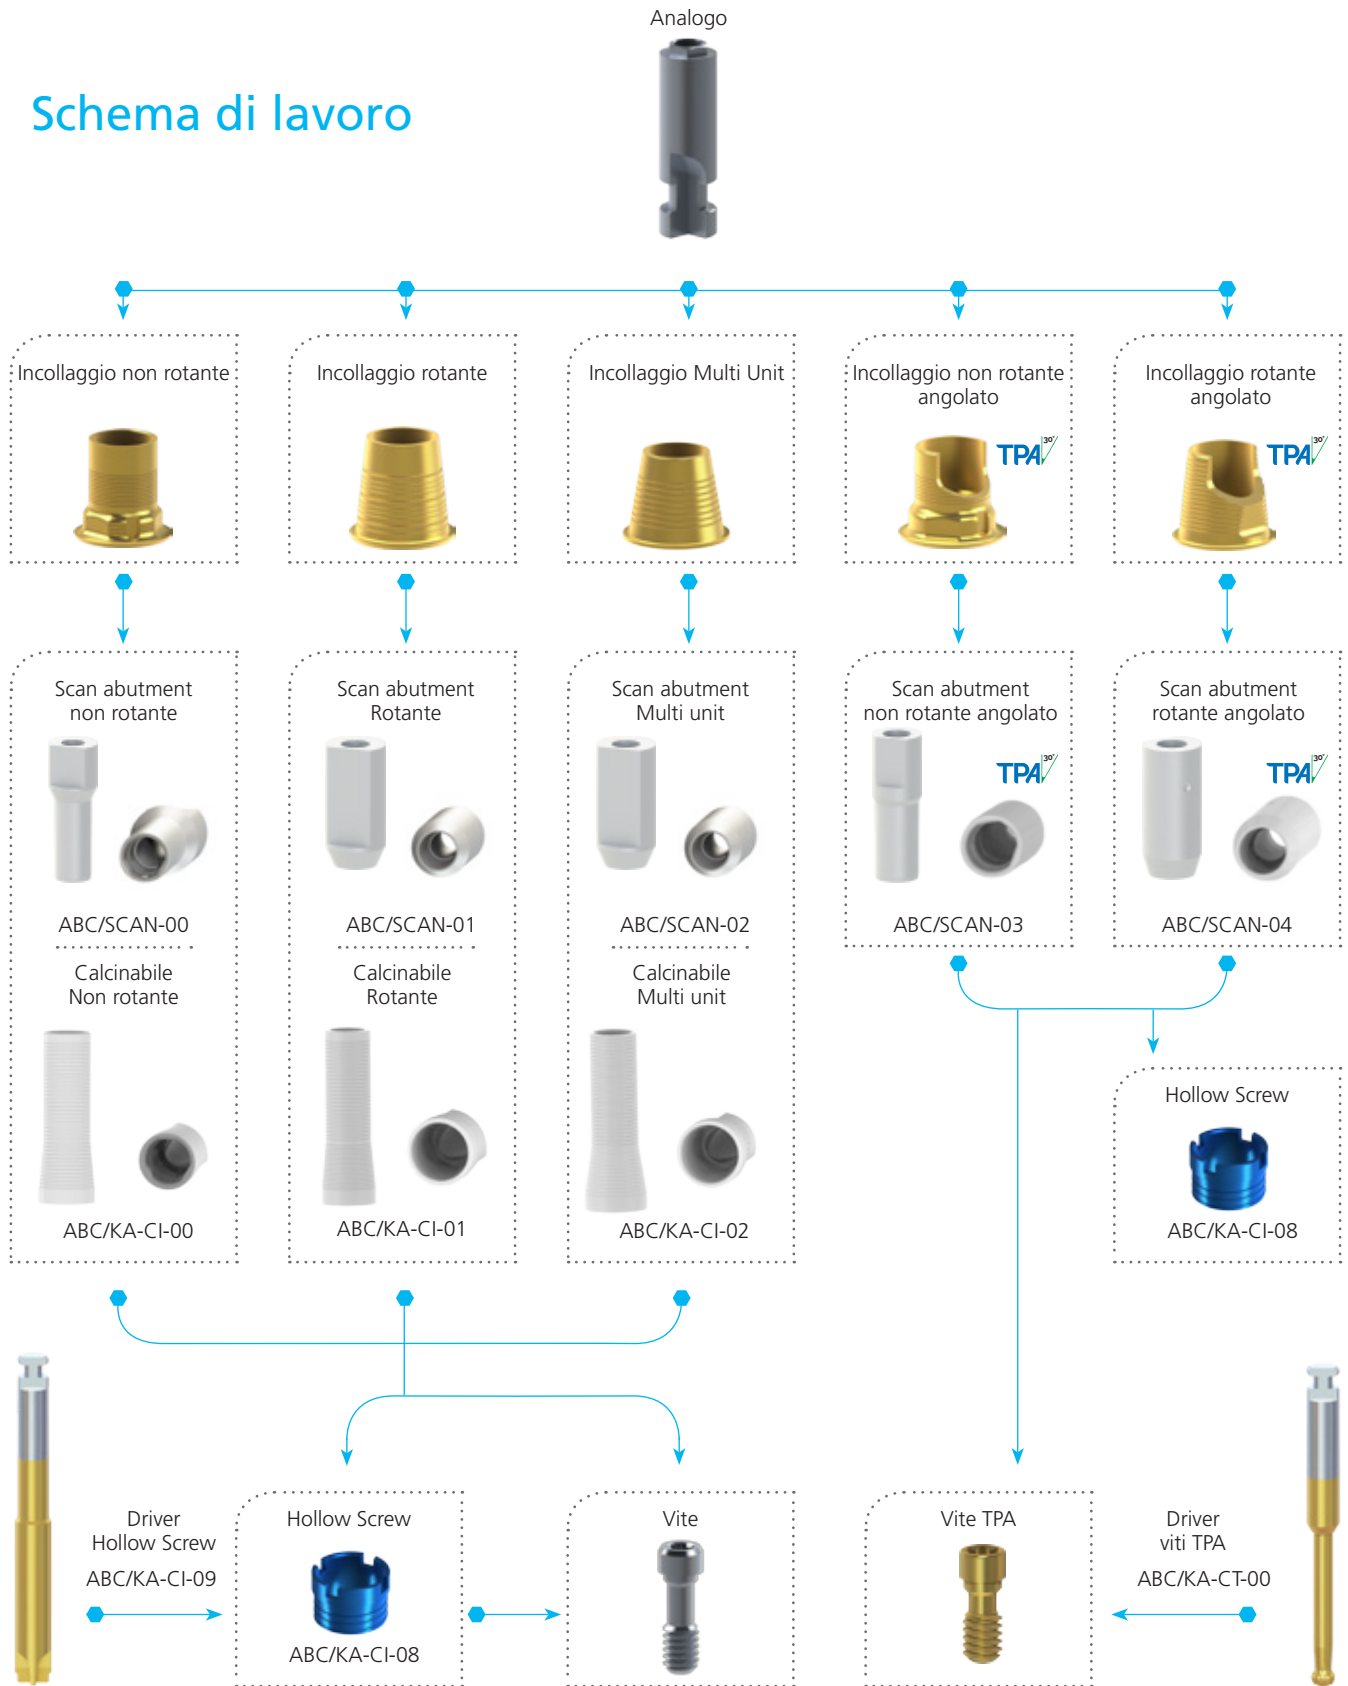

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Scan Body



Scan abutment non rotante

ABC/SCAN-00



Scan abutment rotante

ABC/SCAN-01



Scan abutment Multi Unit

ABC/SCAN-02



Scan abutment non rotante angolato

ABC/SCAN-03



Scan abutment rotante angolato

ABC/SCAN-04



# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Calcinabili



Calcinabile Non rotante

ABC/KA-CI-00



Calcinabile rotante

ABC/KA-CI-01



Calcinabile Multi Unit

ABC/KA-CI-02

## Hollow Screw



ABC/KA-CI-08

## Driver Hollow Screw




ABC/KA-CI-09


# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Librerie CAD-CAM disponibili per i principali sistemi

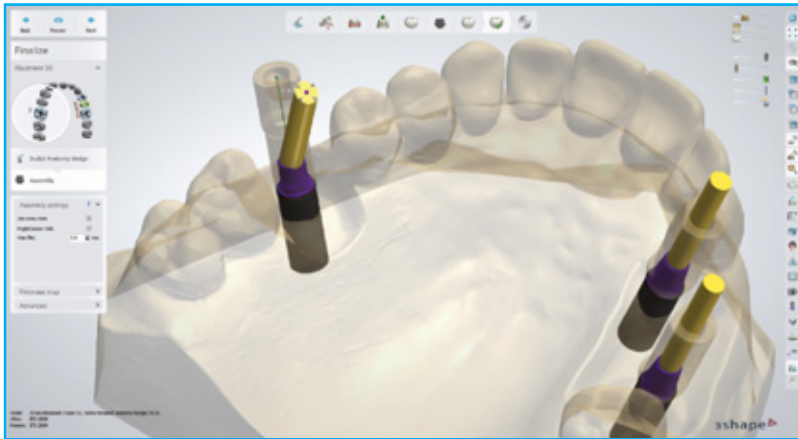

3shape®

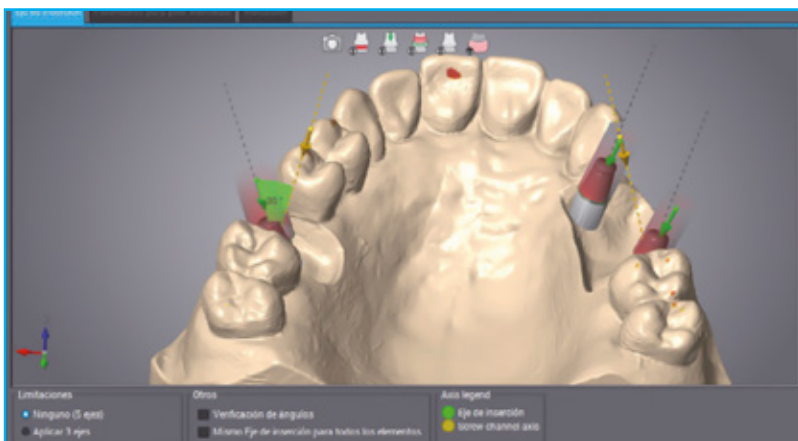

dental wings®



exocad®

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice			
<b>Nobel Biocare®</b> Branemark System® <b>Biomet®</b> 3I® Externa™ 3I® <b>Bti®</b> Hex. Ext. <b>Sweden &amp; Martina®</b> Outlink® <b>Microdent®</b> Microdent® Universal™ <b>Klockner®</b> KL™	Ø4.1	Non Rotante	Dritto	0.2	ABC/AA-IR-00			
			Dritto	1.5	ABC/AA-IR-02			
			Dritto	2.5	ABC/AA-IR-04			
			Angolato	0.2	ABC/AA-IR-30			
			Angolato	0.2	ABC/AA-IR-01			
		Rotante	Dritto	1.5	ABC/AA-IR-03			
			Dritto	2.5	ABC/AA-IR-05			
			Angolato	0.2	ABC/AA-IR-31			
			<b>Nobel Biocare®</b> Branemark System® <b>Klockner®</b> KL™	Ø3.5	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/AA-IN-00
						Dritto	2.5	ABC/AA-IN-02
Angolato	1.0	ABC/AA-IN-30						
Dritto	1.0	ABC/AA-IN-01						
Dritto	2.5	ABC/AA-IN-03						
Rotante	Angolato	1.0			ABC/AA-IN-31			
	Dritto	0.2			ABC/AB-IR-01			
	<b>Nobel Biocare®</b> Nobel Replace® Select	Ø4.3			Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/AC-IN-00
						Dritto	2.5	ABC/AC-IN-02
						Angolato	3.5	ABC/AC-IN-30
Dritto			1.0	ABC/AC-IN-01				
Dritto			2.5	ABC/AC-IN-03				
Rotante			Angolato	3.5	ABC/AC-IN-31			
			Dritto	0.2	ABC/AC-IR-00			
			Dritto	1.5	ABC/AC-IR-02			
			Dritto	2.5	ABC/AC-IR-04			
			Angolato	0.2	ABC/AC-IR-30			
<b>Nobel Biocare®</b> Nobel Replace® Select	Ø5.0	Non Rotante	Dritto	0.2	ABC/AC-IR-01			
			Dritto	1.5	ABC/AC-IR-03			
			Dritto	2.5	ABC/AC-IR-05			
			Angolato	0.2	ABC/AC-IR-31			
			Dritto	0.2	ABC/AC-IW-00			
		Rotante	Dritto	1.5	ABC/AC-IW-02			
			Dritto	2.5	ABC/AC-IW-04			
			Angolato	0.2	ABC/AC-IW-30			
			Dritto	0.2	ABC/AC-IW-01			
			Dritto	1.5	ABC/AC-IW-03			
Angolato	Dritto	2.5	ABC/AC-IW-05					
	Angolato	0.2	ABC/AC-IW-31					

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Nobel Biocare® Nobel Active®</b>	Ø3.5	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IN-00
				2.5	ABC/AD-IN-02
			Angolato	0.9	ABC/AD-IN-30
		Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IN-01
				2.5	ABC/AD-IN-03
			Angolato	0.9	ABC/AD-IN-31
	Ø4.3	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IR-00
				2.5	ABC/AD-IR-02
			Angolato	1.0	ABC/AD-IR-30
		Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IR-01
				2.5	ABC/AD-IR-03
			Angolato	1.0	ABC/AD-IR-31
<b>Biomet® 3I® Externa™ 3I®</b>	Ø3.4	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/BA-IN-00
				2.5	ABC/BA-IN-02
			Angolato	1.0	ABC/BA-IN-30
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/BA-IN-01
				2.5	ABC/BA-IN-03
			Angolato	1.0	ABC/BA-IN-31
	Ø5.0	Non Rotante		0.2	ABC/BA-IW-00
			Dritto	1.5	ABC/BA-IW-02
				2.5	ABC/BA-IW-04
		Rotante	Angolato	0.2	ABC/BA-IW-30
			Dritto	0.2	ABC/BA-IW-01
				1.5	ABC/BA-IW-03
<b>Biomet® 3I® Certain®</b>	Ø3.4	Non Rotante		2.5	ABC/BA-IW-05
			Angolato	0.2	ABC/BA-IW-31
			Dritto	0.9	ABC/BB-IN-00
		Rotante		2.5	ABC/BB-IN-02
			Angolato	0.9	ABC/BB-IN-30
			Dritto	0.9	ABC/BB-IN-01
	Ø4.1	Non Rotante		2.5	ABC/BB-IN-03
			Angolato	0.9	ABC/BB-IN-31
			Dritto	0.3	ABC/BB-IR-00
		Rotante		1.5	ABC/BB-IR-02
				2.5	ABC/BB-IR-04
			Angolato	0.3	ABC/BB-IR-30
	Rotante	Dritto	0.3	ABC/BB-IR-01	
			1.5	ABC/BB-IR-03	
			2.5	ABC/BB-IR-05	
		Angolato	0.3	ABC/BB-IR-31	

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Biomet® 3I® Certain®</b>	Ø5.0	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/BB-IW-00
			Dritto	1.5	ABC/BB-IW-02
			Dritto	2.5	ABC/BB-IW-04
		Rotante	Angolato	0.9	ABC/BB-IW-30
			Dritto	0.3	ABC/BB-IW-01
			Dritto	1.5	ABC/BB-IW-03
<b>Klockner® Essential Cone®</b>	Ø4.5	Non Rotante	Angolato	0.9	ABC/BB-IW-31
			Dritto	0.3	ABC/CB-IR-00
		Rotante	Angolato	0.35	ABC/CB-IR-30
			Dritto	0.3	ABC/CB-IR-01
		Non Rotante	Angolato	0.35	ABC/CB-IR-31
			Dritto	0.85	ABC/DA-IR-00
<b>Straumann® Tissue Level</b>	Ø4.8	Non Rotante	Angolato	0.85	ABC/DA-IR-30
			Dritto	0.85	ABC/DA-IR-01
		Rotante	Angolato	0.85	ABC/DA-IR-11
			Dritto	0.85	ABC/DA-IR-11
		Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/DA-IR-31
			Dritto	1.0	ABC/DB-IN-00
<b>Straumann® Bone Level</b>	Ø3.3	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/DB-IN-02
			Dritto	1.0	ABC/DB-IN-30
		Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IN-01
			Dritto	2.5	ABC/DB-IN-03
		Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IN-31
			Dritto	1.0	ABC/DB-IR-00
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø4.1	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/DB-IR-02
			Dritto	1.0	ABC/DB-IR-30
		Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IR-01
			Dritto	2.5	ABC/DB-IR-03
		Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IR-31
			Dritto	1.5	ABC/EA-IN-00
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø3.0	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/EA-IN-02
			Dritto	1.5	ABC/EA-IN-30
		Rotante	Angolato	1.5	ABC/EA-IN-01
			Dritto	2.5	ABC/EA-IN-03
		Non Rotante	Angolato	1.5	ABC/EA-IN-31
			Dritto	1.1	ABC/EA-IR-00
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø3.5/4.0	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/EA-IR-02
			Dritto	1.1	ABC/EA-IR-30
		Rotante	Angolato	1.1	ABC/EA-IR-01
			Dritto	2.5	ABC/EA-IR-03
		Non Rotante	Angolato	1.1	ABC/EA-IR-31
			Dritto	1.1	ABC/EA-IR-31



# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø4.5/5.0	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/EA-IW-00
			Angolato	2.5	ABC/EA-IW-02
			Angolato	0.9	ABC/EA-IW-30
		Rotante	Dritto	0.9	ABC/EA-IW-01
			Angolato	2.5	ABC/EA-IW-03
			Angolato	0.9	ABC/EA-IW-31
<b>Astra® Evolution®</b>	Ø3.6	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/EB-IN-00
			Angolato	1.0	ABC/EB-IN-30
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/EB-IN-01
	Ø4.2	Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/EB-IN-31
			Dritto	1.0	ABC/EB-IR-00
		Rotante	Angolato	1.0	ABC/EB-IR-01
<b>Zimmer® Screw Vent®</b>	Ø3.5	Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/EB-IR-31
			Dritto	0.9	ABC/FA-IN-00
			Angolato	2.5	ABC/FA-IN-02
		Rotante	Angolato	0.9	ABC/FA-IN-30
			Dritto	0.9	ABC/FA-IN-01
			Angolato	2.5	ABC/FA-IN-03
<b>Bti® Tiny Bti®</b>	Ø3.5	Non Rotante	Angolato	0.9	ABC/FA-IN-31
			Dritto	0.1	ABC/FA-IR-00
			Angolato	1.5	ABC/FA-IR-02
		Rotante	Angolato	2.5	ABC/FA-IR-04
			Dritto	0.1	ABC/FA-IR-30
			Angolato	0.1	ABC/FA-IR-01
<b>Bti® Externa Ancha</b>	Ø5.5	Non Rotante	Dritto	1.5	ABC/FA-IR-03
			Angolato	2.5	ABC/FA-IR-05
			Angolato	0.1	ABC/FA-IR-31
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/GA-IN-00
			Angolato	2.5	ABC/GA-IN-02
			Angolato	1.0	ABC/GA-IN-30
<b>Bti® Externa Ancha</b>	Ø5.5	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/GA-IN-01
			Angolato	2.5	ABC/GA-IN-03
			Angolato	1.0	ABC/GA-IN-31
		Rotante	Dritto	1.6	ABC/GA-IW-00
			Angolato	1.6	ABC/GA-IW-30
			Angolato	1.6	ABC/GA-IW-01
			Angolato	1.6	ABC/GA-IW-31

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice		
<b>Bti®</b> Interna Universal®	Ø5.5	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/GB-IR-00		
				1.5	ABC/GB-IR-02		
				2.5	ABC/GB-IR-04		
			Rotante	Angolato	0.3	ABC/GB-IR-30	
				Dritto	1.5	ABC/GB-IR-03	
				2.5	ABC/GB-IR-05		
			Angolato		0.3	ABC/GB-IR-31	
		<b>Dentsply®</b> Xive® Friadent®		Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/IA-IN-00
					Angolato		ABC/IA-IN-30
Rotante	Dritto		1.0		ABC/IA-IN-01		
	Angolato		1.0	ABC/IA-IN-31			
Non Rotante	Dritto		1.0	ABC/IA-IR-00			
	Angolato			ABC/IA-IR-30			
	Rotante	Dritto	0.5	ABC/IA-IR-01			
	Angolato	ABC/IA-IR-31					
<b>Dentsply®</b> Ankylos®	C/X	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/IA-IW-00		
			Angolato		ABC/IA-IW-30		
			Rotante	Dritto	0.3	ABC/IA-IW-01	
			Angolato	0.3	ABC/IA-IW-31		
		Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/IB-IR-00		
			Angolato		ABC/IB-IR-02		
Dritto	1.0		ABC/IB-IR-01				
Angolato	2.0		ABC/IB-IR-03				
Angolato	1.0		ABC/IB-IR-31				
<b>Camlog®</b> Camlog®	Ø3.3	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/JA-IN-00		
		Rotante			ABC/JA-IN-01		
	Ø3.8	Non Rotante	Dritto	0.7	ABC/JA-IR-00		
		Rotante			ABC/JA-IR-01		
	Ø4.3	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/JA-IW-00		
		Rotante			ABC/JA-IW-01		
<b>BioHorizons®</b> Tapered Internal	Ø3.5	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/LB-IN-00		
			Angolato		ABC/LB-IN-30		
			Rotante	Dritto	0.9	ABC/LB-IN-01	
			Angolato	0.9	ABC/LB-IN-31		
		Non Rotante	Dritto	0.1	ABC/LB-IR-00		
			Angolato		ABC/LB-IR-30		
	Rotante		Dritto	0.1	ABC/LB-IR-01		
		Angolato	ABC/LB-IR-31				

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Sweden &amp; Martina</b> ® Premium™Kohno®	Ø3.8	Non Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IN-00
			Angolato	0.65	ABC/MB-IN-30
	Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IN-01	
		Angolato	0.65	ABC/MB-IN-31	
	Ø4.25	Non Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IR-00
			Angolato	0.65	ABC/MB-IR-30
Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IR-01		
	Angolato	0.65	ABC/MB-IR-31		
<b>Phibo</b> ® TSH®	S2	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/NA-IN-00
			Angolato		ABC/NA-IN-30
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/NA-IN-01
			Angolato		ABC/NA-IN-31